

Suivi radiologique de l'environnement des installations du GIP CYCERON de Caen

Année 2014

Résultats du **deuxième semestre**

Période du 26 juin 2014 au 18 décembre 2014



Feuille Qualité :

DEMANDE	
Mission	Surveillance radiologique de l'environnement du GIP CYCERON – 2 ^{ème} semestre 2014. 1 ^{er} volet : Suivi des émetteurs gamma dans les échantillons biologiques 2 ^{ème} volet : Mesures intégrées du rayonnement ambiant (débit de dose) 3 ^{ème} volet : Cartographie du rayonnement gamma ambiant 4 ^{ème} volet : Contrôle des niveaux de radioactivité des effluents liquides
Demandeur	GIP CYCERON Bd Henri Becquerel – BP 5229 14074 CAEN Cedex 5
Commande	N°14FC2980 du 10/01/14

REALISATION	
Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest 138 rue de l'Eglise 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR tél. : 02.31.94.35.34 / fax : 02.31.94.85.31	
Responsable Scientifique	P. BARBEY, M. JOSSET
Auteur(s)	G. ROUGIER
Prélèvements	A. BERNOLLIN, M. JOSSET, E. DUNAND, G. ROUGIER
Mesures <i>in situ</i>	A. BERNOLLIN, E. DUNAND, M. JOSSET, G. ROUGIER
Traitement des échantillons	E. DUNAND, A. BERNOLLIN, G. ROUGIER
Analyses de radioactivité	A. BERNOLLIN, E. DUNAND, M. JOSSET, G. ROUGIER

DOCUMENT	
Date d'édition	14 janvier 2015
Identification	RAP141218(S2)-CYC-v1
Version n°	01
Pages (nombre)	27 (annexes comprises)
Objet	Matériels et Méthodes, Détails des résultats.
Mots-clés	radioactivité, rayonnement gamma ambiant, débit de dose, recherche médicale, cyclotron, Calvados
Paramètres	éléments radioactifs : ^{24}Na , ^{46}Sc , ^{48}V , ^{51}Cr , ^{52}Mn , ^{54}Mn , ^{55}Co , ^{56}Co , ^{57}Co , ^{58}Co , ^{60}Co , ^{57}Ni , ^{65}Zn , ^{82}Br , ^{122}Sb , ^{124}Sb , ^{123}I , ^{131}Ba , ^{133}Ba , ^{137}Cs , ^{153}Sm , ^{152}Eu , ^{234}Th , ^{212}Pb , ^{40}K , ^7Be . physico-chimiques : néant lieu(x) : Caen (14)

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S)	
de l'A.C.R.O. :	La reproduction du document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

VISA	
Rédacteur	Approbateur
	
Guillaume ROUGIER	Mylène JOSSET

Suivi radiologique de l'environnement des installations du GIP CYCERON – année 2014.

RESULTATS DE LA CAMPAGNE D'ANALYSES DU 2ND SEMESTRE 2014

Période du 26 juin 2014 au 18 décembre 2014

Depuis 2005, l'exploitant du GIP CYCERON a mis en place un plan de surveillance radiologique de l'environnement de ses installations.

L'ACRO a été sollicitée fin 2003 pour la réalisation d'un bilan radiologique de l'environnement terrestre des installations du GIP CYCERON dans le cadre d'un projet d'extension. La surveillance radiologique régulière du site lui a ensuite été confiée de 2005 à 2014 ; une suspension ayant eu lieu entre janvier et septembre 2013.

Le but premier de cette surveillance est de fournir des éléments d'appréciation quant à l'impact de ces installations sur le milieu environnant et les personnes. Cette évaluation participe à la conduite opérationnelle de la radioprotection et permet de s'assurer du respect des seuils réglementaires imposés à l'exploitant du GIP.

L'organisation générale de la surveillance pour la fin de l'année est toujours basée sur un programme qui prend en compte l'exposition externe et le marquage de l'environnement. Depuis le milieu de l'année 2010, une surveillance radiologique périodique des effluents issus des cuves de décroissance a également été mise en place.

Il a été établi le plan suivant, découpé en quatre volets distincts :

- 1^{er} volet : Mesure de radioactivité (émetteurs gamma) dans des échantillons biologiques,
- 2^{ème} volet : Mesure de dosimétrie ambiante intégrée (rayonnement gamma),
- 3^{ème} volet : Evaluation de l'exposition ambiante ponctuelle par cartographie du rayonnement gamma ambiant,
- 4^{ème} volet : Contrôle des effluents avant rejet dans le réseau collectif d'assainissement.

L'ensemble de ces volets est traité dans chacune des communications trimestrielles. Chacun des rapports trimestriels rapporte à la fois les moyens d'études et les résultats des différentes analyses et mesures *in situ*.

Rappel du contexte :

En fonctionnement normal de l'installation, des rejets d'effluents radioactifs gazeux sont effectués régulièrement, principalement par le biais d'émissaires constitués par deux cheminées d'une hauteur d'environ 10 m par rapport au sol. L'une concerne les manipulations opérées au sein du bâtiment B139 (chimie chaude) alors que l'autre s'intéresse à la production de radionucléides à l'aide d'un cyclotron. Si les radionucléides fabriqués, que sont l'oxygène-15, le carbone-11 et le fluor-18, ont une période physique inférieure à 2h, d'autres produits d'activation (de période physique beaucoup

plus longue) sont également formés involontairement et peuvent coexister dans les rejets atmosphériques avec les radionucléides classiques de courtes périodes.

Au cours du bilan radioécologique 2003 ainsi que du suivi réalisé de 2005 à 2013, les analyses effectuées par spectrométrie gamma sur des échantillons d'herbe n'ont révélé aucun marquage¹ durable de l'environnement (c'est à dire décelable sur une période égale ou supérieure à 8 jours) du site du GIP CYCERON en relation avec le fonctionnement normal des installations.

Toutefois, suite aux différentes cartographies du rayonnement gamma ambiant du site, réalisées au cours de ces neuf années, des variations ont été mises en évidence – de manière fluctuante - en plusieurs endroits des 3 hectares du GIP CYCERON. Le relâchement de radionucléides dans l'atmosphère avec les effluents gazeux et le rayonnement de sources radioactives situées à l'intérieur des bâtiments (dans la salle de synthèse notamment) sont les deux principales causes à considérer.

A cela s'ajoute la réorganisation interne du bâtiment du GIP CYCERON. Les abords immédiats de la casemate du cyclotron ont en effet été modifiés afin d'alimenter le site des Laboratoires CYCLOPHARMA (radio-pharmaceutiques). Cette évolution a pour conséquence une augmentation de la production de radio-isotopes par le cyclotron (la nuit en ce qui concerne la production pour CYCLOPHARMA).

En regard de ces informations et dans le cadre d'une surveillance régulière, il convient de poursuivre l'évaluation de l'exposition ambiante ponctuelle et intégrée autour de l'installation du GIP CYCERON.

Etant donné son rôle d'interface privilégiée entre le milieu atmosphérique et le milieu terrestre (sols), le couvert végétal sera utilisé comme bio-indicateur des dépôts de particules radioactives se réalisant à proximité des installations [figure 1].

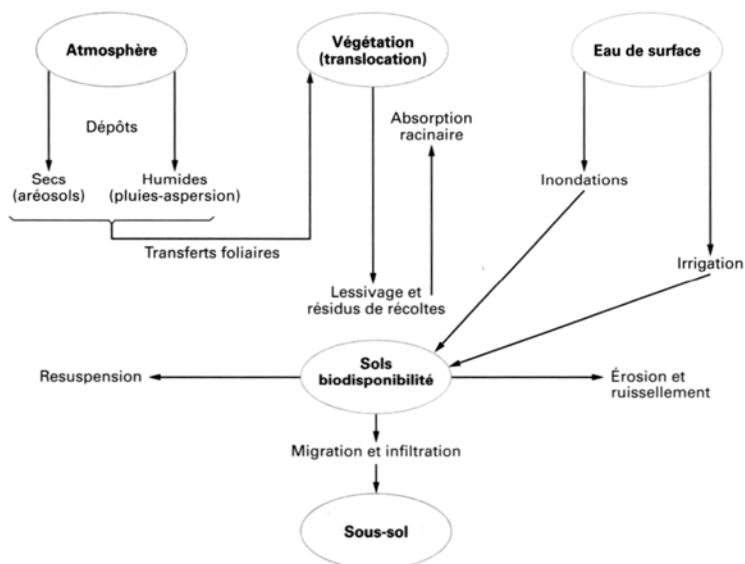


Figure 1 : processus d'échanges des radionucléides dans le milieu terrestre²

¹ à des niveaux significatifs et par des radionucléides émetteurs gamma

² FOURNIER (L.) – Radioécologie, origine des radioéléments. Collection Techniques de l'Ingénieur. Ed. 2002.

Définition des moyens

1. Mesures de radioactivité : émetteurs gamma sur échantillons biologiques

Objectif :

L'approche consiste en la surveillance des radionucléides émetteurs gamma présents dans le compartiment biologique de l'environnement du GIP CYCERON. Ces émetteurs sont caractéristiques de l'environnement et du fonctionnement correct des installations. D'une manière générale, l'intérêt porte sur les radionucléides ayant une période physique suffisamment longue pour induire un marquage durable de l'environnement.

Dans un premier temps, les radionucléides présentés dans les tableaux de résultats sont d'origine naturelle : le béryllium-7, le potassium-40 et les produits de filiation appartenant aux chaînes de l'uranium-238 et du thorium-232.

Concernant la recherche des radionucléides artificiels, l'approche retenue depuis 2003 est basée sur des données bibliographiques recensant les produits issus de l'activation des bétons des enceintes des cyclotrons.

A partir du troisième trimestre 2006, le retour d'expérience relatif à l'analyse qualitative (par spectrométrie gamma) du système de filtration de la casemate du cyclotron du GIP a permis d'élargir le panel des produits d'activation à rechercher. La liste a donc été étendue : le sodium-24, le scandium-46, le cobalt-60, le zinc-65, le brome-82, l'antimoine-122, l'antimoine-124, l'iode-123, le baryum-131, le baryum-133, le césium-137, le samarium-153 et l'euprécium-152. De la même manière, six isotopes supplémentaires ont été ajoutés à cette liste suite à l'analyse effectuée sur de l'eau enrichie ainsi que sur une pièce plastique contaminée lors de la synthèse des radio-isotopes : le manganèse-52, le manganèse-54, le cobalt-55, le cobalt-56, le cobalt-57, le cobalt-58 et le nickel-57. Deux autres radionucléides artificiels ont également été rajoutés à la fin de l'année 2013 suite à une analyse réalisée par le CEA d'un feuillet collant placé dans la casemate du cyclotron : le vanadium-48 et le chrome-51. Un récapitulatif des éléments recherchés est présenté en page 9.

Localisation et nature des prélèvements

La distribution géographique des sites de prélèvements tient compte des potentialités qu'offre le site et de l'intensité estimée des dépôts (secs et humides) relatifs aux émissions gazeuses de l'installation.

La zone de prélèvements concerne les 3 hectares du campus Jules HOROWITZ où est implanté le GIP CYCERON en raison de l'existence théorique de dépôts plus importants qu'ailleurs.

Les évaluations faites à l'aide du code GASCON³ (et notamment les coefficients de transferts atmosphériques (CTA) obtenus pour différents endroits) suggèrent que c'est à moins de 100 m de l'installation que la dilution des gaz rejetés est la moins importante. Tenant compte du cadastre, c'est donc sur les 3 hectares du campus où est implanté le GIP CYCERON que la situation devrait être la plus pénalisante en terme d'exposition.

Note : Jusqu'en avril 2009, l'accès au campus par le public était possible, tout un chacun pouvant circuler librement à proximité des bâtiments constituant l'installation. Depuis cette date,

³ Voir dossier d'enquête publique déposé par CYCERON, version du 17 juin 2003.

seules les personnes travaillant sur le site ou autorisées, ont la possibilité d'accéder aux 3 hectares du campus.

Pour cette étendue, l'échantillonnage concerne un ou plusieurs points, généralement situé(s) sous les vents dominants, dans la limite de 100 m autour des émissaires de rejets gazeux.

Le bioindicateur principal retenu pour cette zone (périmètre de 100 mètres autour des installations) est le couvert végétal (herbe).

Dans le but d'apporter des informations complémentaires sur la qualité de l'environnement autour des installations et, en fonction des potentialités offertes par l'environnement du GIP au long de l'année, deux prélèvements supplémentaires d'indicateurs biologiques atmosphériques (champignons, lichens, aiguilles de pin...) sont prévus.



2. La dosimétrie ambiante intégrée

Objectif :

Evaluer l'impact des installations sur le milieu et les personnes en termes d'exposition externe.

Dispositif :

La dosimétrie sera assurée par un dispositif comprenant une chambre d'ionisation associée à un électret (système E-perm) enfermée dans un sac en Mylar et un sac en plastique étanche, pour éviter notamment, la contribution du gaz radon. La durée d'intégration est fixée à un trimestre et la dose annuelle est calculée à partir du cumul des doses trimestrielles. La sensibilité du dispositif est de 10 μGy pour une dose moyenne mensuelle estimée à environ 75 μGy dans le Calvados d'après le réseau TELERAY.



Une telle sensibilité permet de connaître la contribution liée aux activités du GIP CYCERON avec un bon niveau de confiance.

Localisation :

Les sites de pose des dispositifs intégrateurs sont identiques à ceux choisis pour les prélèvements d'herbe, c'est à dire quatre points distincts (A, B, C & D) distribués à partir de la direction des vents dominants (Sud-Ouest) avec un pas d'environ 90° par rapport à ce même axe.

Un dispositif supplémentaire (E) a été intégré à la surveillance le 6 février 2012. Il est situé entre les bâtiments de CYCLOPHARMA et de CYCERON.

Les résultats obtenus sont comparés à ceux obtenus dans les mêmes conditions opératoires sur le site du laboratoire ACRO (dispositif T, comme « témoin ») situé à plus de 3 kilomètres des installations nucléaires que compte l'agglomération caennaise.

Les dispositifs sont renouvelés chaque trimestre ou dans l'éventualité d'un aléa technique imposant de connaître l'exposition gamma (i.e. suite à un incident lié à des rejets gazeux).

3. Evaluation de l'exposition ambiante ponctuelle

Objectif :

L'approche consiste à vérifier, lors d'une phase d'activité du cyclotron et de production de molécules marquées, le niveau d'exposition dû au rayonnement gamma à l'extérieur des bâtiments. On cherche ainsi à mettre en évidence toute augmentation du rayonnement ambiant, laquelle pourrait avoir comme origine possible :

- une accumulation localisée de radionucléides, déposés ou en suspension dans l'air, à la suite de rejets d'effluents gazeux ;
- l'existence de source(s) d'irradiation en lien avec certaines zones des bâtiments.

L'étendue concernée par les investigations a été définie de manière à intégrer la totalité des 3 hectares du campus Jules HOROWITZ où est implanté le GIP CYCERON car il s'agit de la zone la plus sensible aux dépôts atmosphériques⁴.

Deux parcours sont alors effectués, l'un à l'aplomb des bâtiments, l'autre, aux limites cadastrales du GIP. En fonction des aménagements effectués sur le campus (transformation ou implantation de nouveaux bâtiments), les parcours peuvent être amenés à être modifiés d'un trimestre sur l'autre.

Appareillage :

L'évaluation repose sur la mise en œuvre in situ d'un appareil portatif adapté à la détection des rayonnements gamma, en l'occurrence le DG5 de Novelec. Cet appareil est basé sur l'utilisation d'un capteur à scintillation plastique et d'une électronique à microcontrôleur effectuant l'acquisition et l'interprétation des mesures selon le principe de l'information quantifiée (brevet CEA). L'information délivrée est exprimée en chocs/seconde (c/s) et se réfère au nombre de rayonnements gamma détectés dès lors que leur énergie est supérieure à 50 keV.

Son utilisation est complétée par l'emploi d'un second appareillage de marque APVL (sonde de détection d'irradiation ambiante NBR type FHZ 672 E-10 équipée d'un radiamètre FH 40 G-L10). Cet ensemble permet la détection de sources d'irradiation photon artificielle dans des champs d'irradiation naturelle non homogène et l'expression de débits de dose, le tout sur une gamme d'irradiation très large (entre 1 nSv/h et 100 mSv/h) et avec un temps de réponse très bref. Cet équipement permet la mesure de débit de dose pour des photons à partir de 30 keV.

Méthodologie

Du fait de la rapidité d'acquisition du DG5 et de la fiabilité de la mesure, il n'est pas procédé à des mesures statiques en plusieurs endroits selon un maillage prédéfini (cas de figure habituel) mais à un balayage selon des parcours étudiés de manière à fournir des grandeurs représentatives pour la totalité de la zone étudiée.

En parallèle, et sur les mêmes zones, des gammes de débit de dose sont notées à partir de l'ensemble sonde+radiamètre.

⁴ D'après l'évaluation faite à l'aide du code GASCON (voir dossier d'enquête publique déposé par CYCERON, version du 17 juin 2003).

A chaque fois que le seuil fixé par l'un des appareils est dépassé, l'approche consiste d'une part, à évaluer la superficie concernée, d'autre part, à noter la valeur la plus forte enregistrée et enfin, à évaluer la durée de cette exposition.

Afin d'apprécier les écarts en s'affranchissant des fluctuations du bruit de fond, les résultats sont tous exprimés en pourcentage relatif du seuil de discrimination (SD) ou mouvement propre de l'appareil. Ainsi, toute valeur strictement supérieure au SD témoigne d'une situation radiologique jugée atypique et une valeur de +100% du SD représente approximativement une valeur double de celle du bruit de fond.

Le seuil de discrimination correspond, pour chaque nature de sol différente (terre vs bitume), à la plus forte valeur obtenue lors de mesures statiques effectuées en des endroits non influencés par les activités du GIP CYCERON et similaires en termes de composante radiologique. Ainsi, un nouveau seuil de discrimination est déterminé au préalable à chaque parcours : l'un à partir d'une surface bitumée (revêtement représentatif de la majeure partie de l'aplomb des bâtiments), l'autre à partir d'une surface enherbée représentative de la majeure partie du parcours aux limites cadastrales du GIP.

4. Contrôle des niveaux de radioactivité avant rejet dans le réseau d'assainissement

Objectif :

Evaluer les niveaux de radioactivité (émetteurs gamma et tritium) dans les cuves de décroissance du GIP CYCERON avant rejet dans le réseau collectif d'assainissement.

Contrôle des cuves de décroissance

Le GIP CYCERON est équipé de deux cuves de décroissance (n°1 et n°2) destinées à assurer la décroissance des effluents liquides potentiellement radioactifs avant rejet. Elles sont équipées d'un dispositif d'homogénéisation par air comprimé qui est activé avant chaque prélèvement. Un système de pompage manuel permet de récupérer l'échantillon à l'intérieur de chaque cuve.

Suite à la mise en évidence d'une activité en tritium dans la cuve n°1 (40 Bq/L environ) en juin 2010, il a été décidé d'effectuer un suivi régulier de l'activité tritium et gamma dans ces cuves. Systématiquement, un contrôle est réalisé avant vidange. Les prélèvements ont ainsi lieu toutes les deux semaines et en alternance sur les 2 cuves.

Evolution de la liste des radionucléides gamma recherchés dans les échantillons biologiques et/ou effluents.

En regard du type de radionucléides produits et utilisés sur site, ainsi que du retour d'expérience des différentes analyses conduites à la demande du GIP CYCERON, la liste des radionucléides pris en compte lors des analyses est régulièrement mise à jour.

Ce fut le cas une première fois en 2006 lors de l'analyse du filtre de la casemate du cyclotron puis, fin 2009, lors de l'analyse sur de l'eau enrichie ainsi que sur une pièce plastique contaminée lors de la synthèse des radio-isotopes et enfin, en 2013 suite à l'analyse d'un feuillet collant placé dans l'enceinte du cyclotron.

Cette liste sera alors prise en compte lors des prochaines analyses par spectrométrie gamma conduites sur les échantillons biologiques comme sur les effluents.

	Radionucléide	Période radioactive	
	Emetteurs Gamma		
Radionucléides artificiels (produits d'activation)	24 Na : Sodium-24	14,96 h	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 20px;">} Identifiés lors de l'analyse du filtre de la casemate du cyclotron.</div> <div style="margin-bottom: 20px;">} Identifiés lors de l'analyse de l'eau enrichie et de la QMA de purification des ions ¹⁸F.</div> <div>} Identifiés lors de l'analyse d'un feuillet collant placé dans l'enceinte du cyclotron</div> </div>
	46 Sc : Scandium-46	83,8 j	
	60 Co : Cobalt-60	5,3 ans	
	65 Zn : Zinc-65	244,15 j	
	82 Br : Brome-82	1,47 j	
	122 Sb : Antimoine-122	2,7 j	
	124 Sb : Antimoine-124	60,2 j	
	123 I : Iode-123	13,21 h	
	137 Cs : Césium-137	30,0 ans	
	131 Ba : Baryum-131	11,5 j	
	133 Ba : Baryum-133	10,57 ans	
	153 Sm : Samarium-153	1,9 j	
	152 Eu : Europium-152	13,4 ans	
	52 Mn : Manganèse-52	5,59 j	
	54 Mn : Manganèse-54	312,13 j	
	55 Co : Cobalt-55	17,5 h	
	56 Co : Cobalt-56	77,3 j	
57 Co : Cobalt-57	271,79 j		
58 Co : Cobalt-58	70,86 j		
57 Ni : Nickel-57	36 h		
48 V : Vanadium-48	16,0 j		
51 Cr : Chrome-51	27,7 j		
Radionucléides naturels	40 K : Potassium-40	1,3 10 ⁹ ans	
	7 Be : Béryllium-7	53,2 jours	
	Emetteur Bêta		
	3 H : Tritium	12,3 ans	

Tableau 1: liste des radionucléides gamma recherchés dans les échantillons biologiques et/ou effluents

Résultats

Premier Volet :

MESURE DE RADIOACTIVITE SUR ECHANTILLONS

BIOLOGIQUES

Couvert végétal et matrice biologique

LOCALISATION ET DESCRIPTION DES PRELEVEMENTS

PRELEVEMENT DE COUVERT VEGETAL :

L'analyse des niveaux de radioactivité dans le couvert végétal du campus Horowitz peut s'effectuer à partir d'un échantillon obtenu de deux manières différentes. Il peut s'agir soit d'un échantillon composite (ou échantillon moyen) obtenu par homogénéisation des sous-échantillons prélevés dans les mêmes proportions sur chacun des sites A, B, C et D ; soit d'un échantillon unique, prélevé en un seul et même endroit.

- Un échantillon composite de couvert végétal (herbe) a été prélevé le 11 décembre 2014, simultanément à la production de fluor-18 par le cyclotron. L'échantillon analysé a été obtenu par homogénéisation de deux sous-échantillons prélevés dans les mêmes proportions à proximité des sites C et B, situés dans la direction des vents pour ce jour (nord-nord-est).

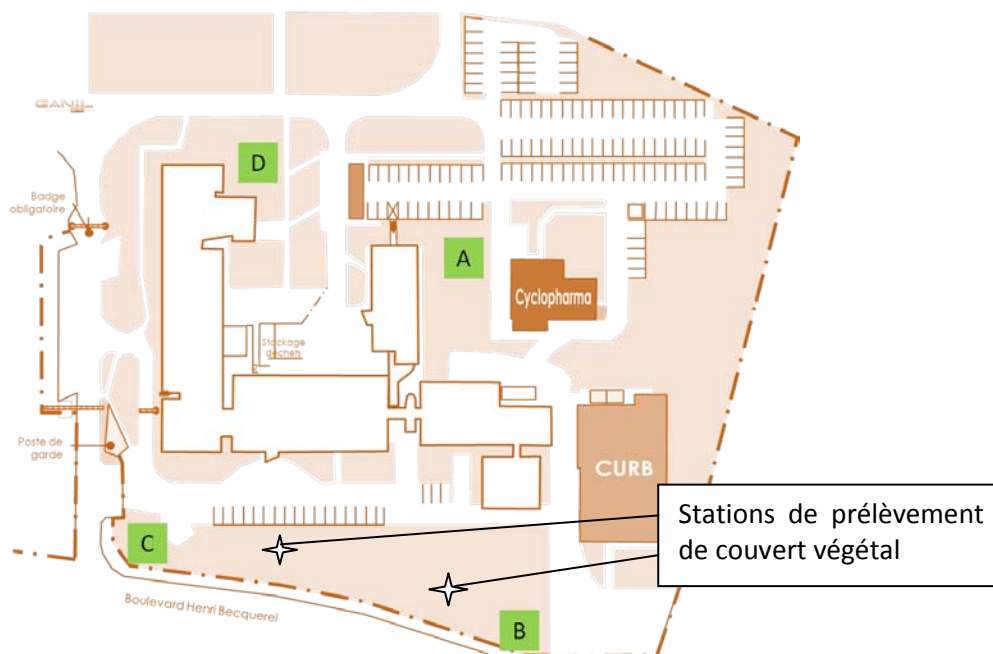


Figure 2 : localisation des stations de prélèvement de couvert végétal

OBSERVATIONS

L'échantillon a été analysé par spectrométrie gamma. Les résultats sont présentés dans le tableau 2 ci-après.

Les résultats ne mettent pas en évidence la présence de radionucléides artificiels à des niveaux significatifs. Les éléments naturels rencontrés sont présents à des activités couramment observées dans des environnements non influencés par des activités nucléaires.

ECHANTILLON		
Dénomination	Couvert végétal	
Catégorie/Espèce	Herbe	
PRELEVEMENT		
Date	11 décembre 2014	
Localisation	Sites B et C	
Distance/émissaire	80m environ	
Site	CYCERON	
Département	14	
COMPTAGE		
n° d'enregistrement	141211-CYC-01	
n° de manipulation	7919	
Géométrie (en cc)	500	
Masse d'échantillon analysé (équivalent g sec)	40	
Age de l'échantillon (jours)	0	
Age du conditionnement (jours)	0	
Fraction analysée	Totale	
Etat du conditionnement	Frais	
Psec/Pfrais	16,0%	
Densité analysée	0,5	
EXPRESSION DES RESULTATS		
Date de référence	11 décembre 2014	
Unité	Bq/kg sec	
Emetteurs Gamma Artificiels		
²⁴ Na - Sodium-24	14,96 h	< 9
⁴⁶ Sc - Scandium-46	83,8 j	< 5
⁴⁸ V - Vanadium-48	16,0 j	< 5
⁵¹ Cr - Chrome-51	27,7 j	< 28
⁵² Mn - Manganèse-52	5,59 j	< 6
⁵⁴ Mn - Manganèse-54	312, 13 j	< 5
⁵⁵ Co - Cobalt-55	17,5 h	< 12
⁵⁶ Co - Cobalt-56	77,3 j	< 5
⁵⁷ Co - Cobalt-57	271, 79 j	< 2
⁵⁷ Ni -Nickel-57	36 h	< 8
⁵⁸ Co - Cobalt-58	70,86 j	< 4
⁶⁰ Co - Cobalt-60	5,3 a	< 5
⁶⁵ Zn - Zinc-65	244,15 j	< 10
⁸² Br - Brome-82	1,47 j	< 8
¹²² Sb - Antimoine-122	2,7 j	< 6
¹²⁴ Sb - Antimoine-124	60,2 j	< 4
¹²³ I - Iode-123	13,21 h	< 6
¹³⁷ Cs - Césium-137	30,0 a	< 5
¹³¹ Ba - Baryum-131	11,5 j	< 8
¹³³ Ba - Baryum-133	10,57 a	< 5
¹⁵² Eu - Europium-152	1,9 j	< 11
¹⁵³ Sm - Samarium-153	13,4 a	< 7
Emetteurs Gamma Naturels		
⁴⁰ K - Potassium-40	1,3.10 ⁹ a	750 ± 100
⁷ Be - Béryllium-7	53,2 j	303 ± 36

Tableau 2 : résultat de l'analyse réalisée par spectrométrie gamma sur un échantillon de couvert végétal prélevé le 11 décembre 2014

Deuxième Volet :

MESURE DE LA DOSIMETRIE AMBIANTE INTEGREE Mesure de dose moyenne et intégrée

LOCALISATION DES SITES DE MESURE

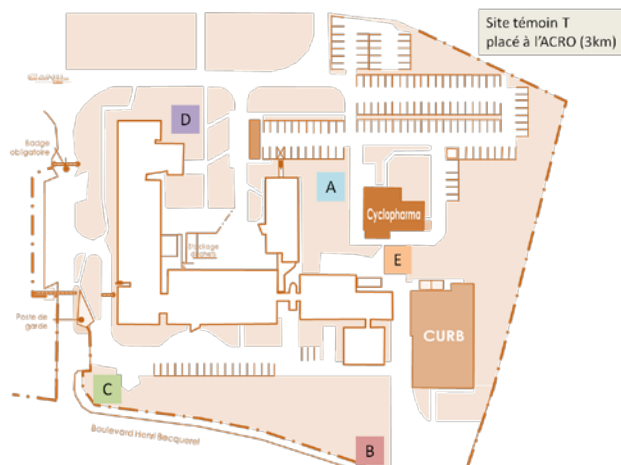


Figure 3 : localisation des sites de mesure du 25 juin au 23 octobre 2014 et du 23 octobre au 18 décembre 2014

RESULTATS

3^{ème} trimestre 2014

Période d'intégration du 25 juin au 23 octobre 2014

Localisation des dispositifs intégrateurs	Site A	Site B	Site C	Site D	Site E	Site Témoin
Débit de dose moyen ($\mu\text{Sv/h}$ ou $\mu\text{Gy/h}$)	0,095 \pm 0,005	0,095 \pm 0,005	0,100 \pm 0,005	0,102 \pm 0,005	0,180 \pm 0,009	0,092 \pm 0,005
Dose cumulée sur la période d'intégration (mGy)	0,272 \pm 0,014	0,275 \pm 0,014	0,287 \pm 0,014	0,295 \pm 0,015	0,520 \pm 0,026	0,266 \pm 0,013

Tableau 3 : débit de dose moyen (en $\mu\text{Sv/h}$ ou $\mu\text{Gy/h}$) et dose cumulée (mGy) sur la période d'intégration du 25 juin au 23 octobre 2014

4^{ème} trimestre 2014

Période d'intégration du 23 octobre au 18 décembre 2014

Localisation des dispositifs intégrateurs	Site A	Site B	Site C	Site D	Site E	Site Témoin
Débit de dose moyen ($\mu\text{Sv/h}$ ou $\mu\text{Gy/h}$)	0,100 \pm 0,005	0,107 \pm 0,005	0,106 \pm 0,005	0,104 \pm 0,005	0,225 \pm 0,011	0,086 \pm 0,004
Dose cumulée sur la période d'intégration (mGy)	0,134 \pm 0,007	0,143 \pm 0,007	0,143 \pm 0,007	0,140 \pm 0,007	0,303 \pm 0,150	0,116 \pm 0,006

Tableau 4 : débit de dose moyen (en $\mu\text{Sv/h}$ ou $\mu\text{Gy/h}$) et dose cumulée (mGy) sur la période d'intégration du 23 octobre au 18 décembre 2014

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Les débits de doses moyens mesurés sur **les sites A, B, C et D** (suivis depuis 2005) au cours des troisième et quatrième trimestres sont sensiblement équivalents entre eux aux incertitudes de mesures près (0,005 µSv/h). L'exposition maximale relevée au troisième trimestre a été mesurée sur le site D avec un débit de dose moyen de 0,102 ± 0,005 µSv/h. Au quatrième trimestre, l'exposition maximal a été mesurée sur le site B avec un débit de dose moyen de 0,107 ± 0,005 µSv/h. Ces deux mesures présentent respectivement un écart de 11 et 24% par rapport aux mesures effectuées sur le site témoin. La situation est relativement comparable à celle des trimestres précédents.

L'exposition la plus importante a été mesuré sur le **site E** (balise installée en février 2012) situé entre les bâtiments de Cyceron et de Cyclopharma. Le débit de dose moyen au quatrième semestre est de 0,225 ± 0,011 µSv/h, soit un écart de 162% par rapport à la mesure réalisée sur le site témoin.

A noter que les deux périodes d'intégrations du semestre ont été significativement différentes (120 jours au troisième trimestre et 56 jours au quatrième), c'est pourquoi les doses cumulées sur chacun des deux trimestres sont différentes.



Figure 4 : débits de dose moyens pour les deux derniers trimestres 2014

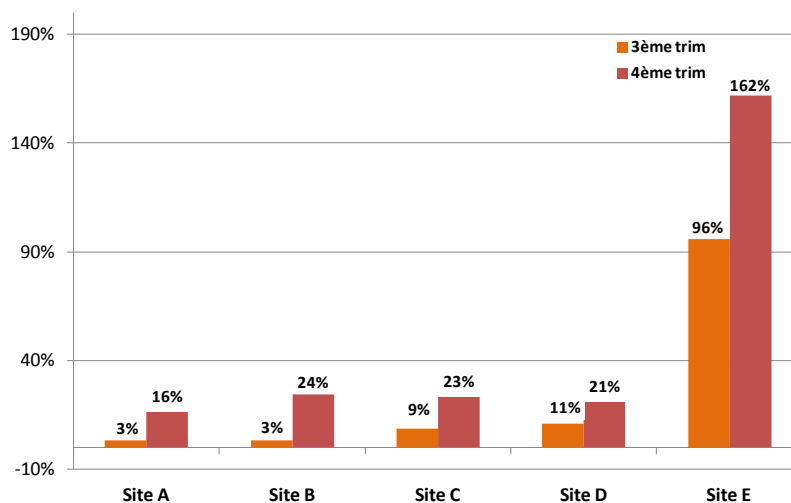


Figure 5 : écarts par rapport au site témoin pour les deux derniers trimestre 2014

EVOLUTION DEPUIS 2005

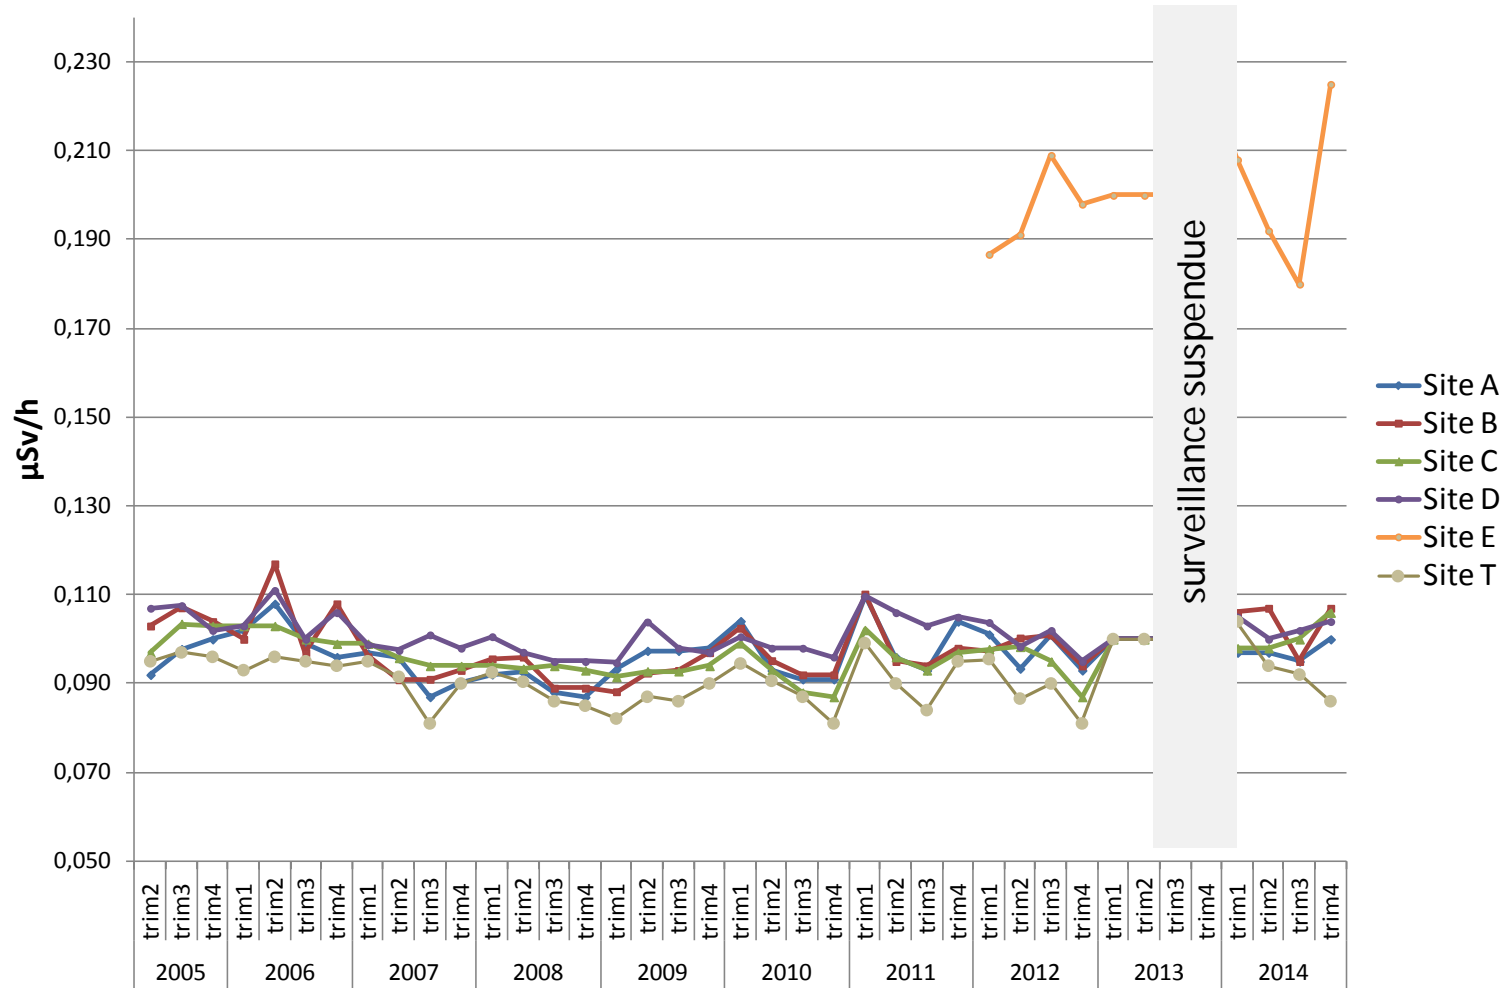


Figure 6 : évolution des débits de dose relevés depuis 2005 chaque trimestre dans l'environnement de Cycleron

Les limites cadastrales du site

DETAIL DU PARCOURS EFFECTUE

Le parcours a été réalisé le 11 décembre 2014 consécutivement à la production de fluor-18 (production de 9h à 11h).

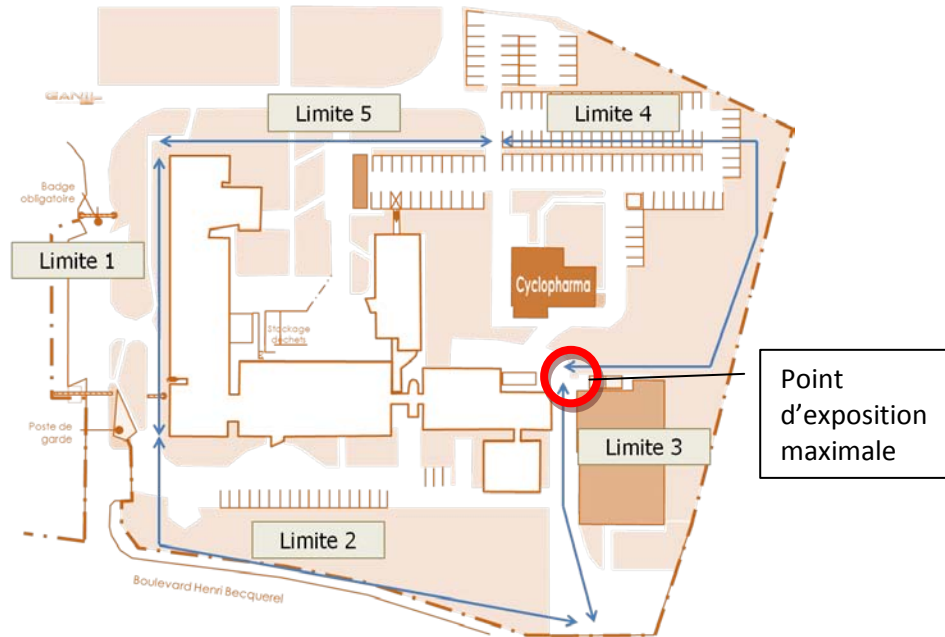


Figure 7 : détail du parcours

RESULTATS DE MESURES

Valeur de référence couvert végétal: **80 chocs par seconde**

Parcours	Heure	Mini	Maxi	% du SD
Limite 1	10h25	80	110	38%
Limite 2	10h00	80	220	175%
Limite 3	10h06	90	1400	1650%
Limite 4	10h13	90	140	75%
Limite 5	10h21	100	115	44%

Tableau 5 : résultats de mesures réalisées lors du parcours (limites cadastrales du site) le 11 décembre 2014

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Sur le parcours, il a été noté une exposition significativement supérieure au seuil de discrimination à la limite des zones 3 et 4, soit au point le plus proche du bâtiment Cyclopharma. Le débit de dose instantané maximal mesuré sur le parcours est de 0,46 $\mu\text{Sv/h}$.

Troisième Volet : EVALUATION DE L'EXPOSITION GAMMA AMBIANTE PONCTUELLE

Rayonnement gamma ambiant

Le long des bâtiments

DETAIL DU PARCOURS EFFECTUE

Le parcours a été réalisé le 11 décembre 2014 consécutivement à la production de fluor-18 (production de 9h à 11h).



Figure 8 : détaille du parcours

RESULTATS DE MESURES

Valeur de référence bitume: **130 chocs par seconde**

Parcours	Heure	Mini	Maxi	% du SD
parcours A	10h25	85	110	-15%
parcours B	10h26	85	110	-15%
parcours C	10h29	85	130	0%
parcours D	10h32	130	1200	823%
parcours E	10h34	130	1200	823%
parcours F	10h50	90	130	0%
parcours G	10h54	110	140	8%
parcours H	10h56	90	140	8%
parcours I	11h02	90	125	-4%

Tableau 6 : résultats des mesures réalisées lors du parcours (le long du bâtiment) le 11 décembre 2014

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Lors du parcours une élévation significative a été relevée le long du parcours E, au contact du local à déchets : le débit de dose maximum mesuré été de 1,7 $\mu\text{Sv/h}$.

On note également une élévation significative de la dosimétrie ambiante au fur et à mesure que l'on s'approche du bâtiment Cyclopharma : jusqu'à 12 $\mu\text{Sv/h}$ à 2 mètres de l'entrée du bâtiment.

Quatrième volet :

CONTROLE DES NIVEAUX DE RADIOACTIVITE DES EFFLUENTS

LIQUIDES

Mesure des émetteurs gamma

Dénomination	Effluent	Effluent	Effluent	Effluent	Effluent	Effluent	Effluent	Effluent
Catégorie	cuve de	cuve de	cuve de	cuve de	cuve de	cuve de	cuve de	cuve de
	décroissance n°1	décroissance n°2	décroissance n°1	décroissance n°2	décroissance n°1	décroissance n°2	décroissance n°1	décroissance n°2
Prélèvement								
Date	15/07/2014	21/07/2014	08/09/2014	29/09/2014	13/10/2014	03/11/2014	24/11/2014	15/12/2014
Site	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON
Analyse								
n° de d'enregistrement	140715-CYC-01	140721-CYC-01	140908-CYC-01	140929-CYC-01	141013-CYC-01	141103-CYC-01	141124-CYC-01	141215-CYC-01
n° de manipulation	V2-1198	V2-1202	V2-1220	V2-1234	V2-1243	V2-1259	V2-1274	7922
Fraction analysée	brute	brute	brute	brute	brute	brute	brute	brute
Densité analysée	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Date de la mesure	15/07/2014	21/07/2014	08/09/2014	01/10/2014	13/10/2014	04/11/2014	24/11/2014	16/12/2014
temps de comptage (s)	158929 s	139999 s	230298 s	83984 s	85910 s	84938 s	145805 s	89074 s
Expression des résultats								
Date de référence	15/07/2014	21/07/2014	08/09/2014	29/09/2014	13/10/2014	03/11/2014	24/11/2014	15/12/2014
Unité	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l
Radionucléides artificiels								
Na-24 sodium-24 14,96 h	< 0,5	< 0,7	< 0,7	< 4,2	< 0,7	< 1,3	< 0,6	< 1,9
Sc-46 scandium-46 83,8 j	< 0,16	< 0,17	< 0,14	< 0,25	< 0,23	< 0,24	< 0,17	< 0,35
V-48 vanadium-48 16,0 j	< 0,18	< 0,19	< 0,15	< 0,26	< 0,25	< 0,27	< 0,19	< 0,36
Cr-51 chrome-51 27,7 j	< 1,1	< 1,3	< 1,0	< 1,7	< 1,6	< 1,6	< 1,2	< 2,6
Mn-52 manganèse-52 5,59 j	< 0,20	< 0,21	< 0,18	< 0,32	< 0,26	< 0,3	< 0,22	< 0,44
Mn-54 manganèse-54 312,13 j	< 0,16	< 0,19	< 0,13	< 0,23	< 0,25	< 0,23	< 0,17	< 0,34
Co-55 cobalt-55 17,5 h	< 0,48	< 0,6	< 0,7	< 3,0	< 0,6	< 1,1	< 0,6	< 2,0
Co-56 cobalt-56 77,3 j	< 0,17	< 0,17	< 0,14	< 0,26	< 0,24	< 0,24	< 0,19	< 0,36
Co-57 cobalt-57 271,79 j	< 0,09	< 0,09	< 0,07	< 0,12	< 0,12	< 0,12	< 0,09	< 0,19
Co-58 cobalt-58 70,86 j	< 0,16	< 0,17	< 0,13	< 0,23	< 0,22	< 0,21	< 0,17	< 0,35
Co-60 cobalt-60 5,27 a	< 0,19	< 0,22	< 0,15	< 0,27	< 0,26	< 0,27	< 0,21	< 0,37
Ni-57 nickel-57 36 h	< 0,34	< 0,40	< 0,40	< 1,1	< 0,47	< 0,6	< 0,43	< 1,0
Zn-65 zinc-65 244,15 j	< 0,37	< 0,40	< 0,32	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,37	< 0,7
Br-82 brome-82 1,47 j	< 0,29	< 0,34	< 0,30	< 0,8	< 0,39	< 0,5	< 0,35	< 0,9
Sb-122 antimoine-122 2,7 j	< 0,25	< 0,27	< 0,24	< 0,5	< 0,33	< 0,41	< 0,27	< 0,7
Sb-124 antimoine-124 60,2 j	< 0,16	< 0,17	< 0,13	< 0,23	< 0,24	< 0,23	< 0,17	< 0,35
I-123 iode-123 13,21 h	< 0,28	< 0,38	< 0,41	< 3,1	< 0,36	< 0,8	< 0,37	< 1,4
Cs-137 césium-137 30,0 a	< 0,17	< 0,18	< 0,15	< 0,24	< 0,23	< 0,24	< 0,18	< 0,37
Ba-131 baryum-131 11,5 j	< 0,30	< 0,34	< 0,26	< 0,47	< 0,41	< 0,45	< 0,33	< 0,6
Ba-133 baryum-133 10,57 a	< 0,18	< 0,19	< 0,15	< 0,24	< 0,25	< 0,26	< 0,20	< 0,39
Sm-153 samarium-153 1,9 j	< 0,33	< 0,38	< 0,34	< 0,8	< 0,44	< 0,5	< 0,38	< 0,9
Eu-152 europium-152 13,4 a	< 0,44	< 0,47	< 0,34	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,42	< 0,9
Radionucléides naturels								
K-40 potassium-40 1,3.10 ⁹ a	< 3,0	< 3,4	< 2,6	< 3,7	< 4,1	< 4,4	< 3,3	< 8
Be-7 béryllium-7 53,2 j	< 1,2	< 1,3	< 1,0	< 1,8	< 1,7	< 1,8	< 1,3	< 2,8

Tableau 7 : résultats de mesures des émetteurs gamma dans les cuves de décroissance

Quatrième volet : **CONTROLE DES NIVEAUX DE RADIOACTIVITE DES EFFLUENTS**
LIQUIDES
Mesure du tritium

Dénomination	Effluent cuve de décroissance n°1	Effluent cuve de décroissance n°2	Effluent cuve de décroissance n°1	Effluent cuve de décroissance n°2	Effluent cuve de décroissance n°1	Effluent cuve de décroissance n°2	Effluent cuve de décroissance n°1	Effluent cuve de décroissance n°2
Prélèvement								
Date	15/07/2014	21/07/2014	08/09/2014	29/09/2014	13/10/2014	03/11/2014	24/11/2014	15/12/2014
Site	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON	CYCERON
Analyse								
n° de d'enregistrement	140715-CYC-01	140721-CYC-01	140908-CYC-01	140929-CYC-01	141013-CYC-01	141103-CYC-01	141124-CYC-01	141215-CYC-01
n° de manipulation	MS01	MT12	MU01	MW10	MX14	MZ11	OB13	OD11
Fraction analysée	brute	brute	brute	brute	brute	brute	brute	brute
Densité analysée	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Expression des résultats								
Date de référence	15/07/2014	21/07/2014	08/09/2014	29/09/2014	13/10/2014	03/11/2014	24/11/2014	15/12/2014
Unité	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l	Bq/l
Radionucléides artificiels								
H-3 tritium 12,32 a	< 7	< 7	< 7	< 7	< 7	< 7	< 7	< 7

Tableau 8 : résultats de mesures du tritium dans les cuves de décroissance

Annexes

ANNEXE 1 : Matériel et méthodes

Les méthodes citées ci-après sont employées dans le respect des recommandations de la série de normes AFNOR NF M60-780 relatives aux techniques d'échantillonnage d'indicateurs de l'environnement ainsi qu'à leur préparation et à leur conservation.

1. Méthodologie employée pour le prélèvement des échantillons biologiques

Pour l'ensemble des prélèvements effectués, une même ligne méthodologique a été observée :

- Le renseignement, pour chaque échantillon, d'une fiche comprenant entre autre, la date, l'heure, la position GPS, les conditions météorologiques et les caractéristiques physiques de l'échantillon.
- Le conditionnement immédiat de l'échantillon sous sachet en polyéthylène individuel référencé.
- La conservation des échantillons au laboratoire à 4°C en attente de traitement et de conditionnement (le temps d'attente n'excédant pas 48h).

Le couvert végétal (herbe) : un prélèvement manuel est effectué pour chacun des quatre points et la surface prise en référence s'étend sur 1m² (quadrat). A l'intérieur de cette zone, l'ensemble du couvert végétal est prélevé. La fraction prélevée de cet indicateur concerne uniquement la partie aérienne des plants, le mat étant écarté. Aucune différenciation d'espèces n'est effectuée.

Les autres indicateurs atmosphériques (lichens, champignons) : le choix de ces indicateur est fonction de la saison. Le prélèvement est effectué manuellement et de manière à obtenir un échantillon représentatif de la zone de répartition de l'espèce.

2. Méthodologie employée pour le traitement des échantillons biologiques

Le couvert végétal (herbe) : aucun traitement n'est appliqué, les brins de chaque station sont coupés afin qu'ils n'excèdent pas une longueur de 5 cm. Une aliquote de 62,5 g représentative de chaque échantillon est alors retenue, afin de réaliser un échantillon moyen des quatre sites, d'une masse de 250 g, conditionné en géométrie de type SG 500, d'un volume utile de 500 ml, pour comptage en spectrométrie gamma. A l'issue de l'analyse, l'échantillon est desséché à 60°C afin de déterminer le rapport Poids sec / Poids frais.

Les autres indicateurs (lichens, champignons...) : en fonction de la quantité récoltée, il est soit procédé à un comptage à frais des échantillons, soit à leur séchage à 60°C en étuve ventilée. Dans ce cas, le résidu sec est ensuite réduit en poudre et homogénéisé puis conditionné en géométrie adaptée au comptage par spectrométrie gamma.

3. Matériel employé pour les mesures in situ

Détecteur gamma portatif DG5 de NOVELEC

Il s'agit d'un détecteur à scintillateur organique associé à un photomultiplicateur sensible au rayonnement gamma ambiant. La réponse donnée en coups par seconde (c/s) traduit le nombre de rayonnement détecté sans tenir compte de leur énergie dès lors que celle-ci est supérieure au seuil de détection (50 keV).

Sonde NBR FHZ 672 E10 + Radiamètre FH4OGL-10 d'APVL

Il s'agit d'une sonde à scintillation (*scintillateur organique et scintillateur NaI*) avec photomultiplicateur intégré, destinée à la mesure de débits d'équivalents de dose gamma et X. La gamme de mesure de débit de dose s'étend de 0,001 μ Sv/h à 100mSv/h ; la gamme de mesure de dose, de 100 nSv à 1 Sv et la gamme d'énergie, de 30 keV à 1,5 MeV.

4. Méthodologie employée pour le prélèvement des échantillons d'effluents liquides

Le prélèvement des échantillons d'effluents liquides est assuré par le laboratoire départemental d'analyse du Calvados, lequel achemine à l'ACRO les échantillons directement dès la fin du prélèvement. Celui-ci est effectué sur une période de 8 heures au moyen d'un dispositif automatique de pompage, permettant de récolter un échantillon moyen sur l'ensemble de la journée.

5. Méthodologie employée pour le prélèvement des échantillons de cuves de décroissance

Un dispositif d'homogénéisation par air comprimé est activé avant le prélèvement sur chacune des cuves de décroissance. Un système de pompage manuel permet ensuite de récupérer 500ml d'échantillon à l'intérieur de chaque cuve.

6. Méthodologie employée pour le traitement des échantillons d'effluents liquides et des cuves de décroissance

Après homogénéisation énergétique, l'échantillon initial est placé au repos pendant douze heures, temps nécessaire à la sédimentation à gravité unitaire.

Une aliquote de 500 ml d'eau résiduaire ainsi décantée, est ensuite prélevée par pipetage puis conditionnée dans une géométrie de comptage de 500 cm³ (type SG500) adaptée à la mesure par spectrométrie gamma.

7. Analyse par spectrométrie gamma

La mesure des émetteurs gamma est effectuée avec une chaîne de spectrométrie gamma Ortec de type N équipée d'un château de plomb d'épaisseur 10 cm. La chaîne d'analyse comprend un analyseur « DSPEC », système d'acquisition numérique (Ortec), associé à un détecteur au germanium hyperpur de type N (Ortec), d'efficacité 32%, monté dans un cryostat vertical. La plage d'énergie prise en référence s'étend de 20 à 2000 keV pour l'analyse qualitative et de 60 à 2000 keV pour l'analyse quantitative, hormis dans le cas de l'iode-129. L'atténuation due à la densité de l'échantillon est prise en compte pour des énergies supérieures à 60 keV et les facteurs correctifs sont déterminés par calcul par la méthode semi-empirique basée sur l'assimilation du détecteur à un point. Néanmoins, pour des énergies inférieures à 100 keV, les phénomènes d'auto-atténuation en rapport avec la composition intrinsèque de l'échantillon sont généralement prépondérants. Aussi, les résultats pour les radionucléides émetteurs gamma de faible énergie (<100 keV) sont à considérer avec prudence (234Th). L'efficacité de référence du détecteur pour la plage d'énergie prise en référence est déterminée à l'aide d'une source liquide multi-radionucléide et d'une source liquide de ¹³³Ba en tenant compte des phénomènes de sommation de coïncidences qui existent avec ce radionucléide. Les sources employées sont des solutions étalons certifiées. Les flacons utilisés pour la spectrométrie gamma sont en polyéthylène translucide de type SG500 ou SG50 jaugés d'un volume utile de 500 ml ou 50 ml.

MESURE DES EMETTEURS GAMMA

Les mesures sont réalisées avec des géométries identiques à celles des sources de référence (SG500 ou SG50) et concernent les radionucléides émetteurs gamma présentant une ou plusieurs raies d'émission sur la plage d'énergie prise en référence. Parmi l'ensemble des radionucléides évoqués précédemment, seuls les plus caractéristiques sont présentés dans les tableaux de résultats (voir tableau 1) en l'absence de demande spécifique par le client. Dans tous les cas, le tableau fait état, au minimum, de tous les radionucléides artificiels détectés. Seules les activités supérieures à la limite de détection de la chaîne d'analyse sont exprimées. Dans le cas contraire et pour les seuls radionucléides mentionnés, la limite de détection précédée du signe " < " est rapportée. Lorsqu'un radionucléide mentionné n'a pas été recherché, la mention « non recherché » (nr) est rapportée. L'activité de chaque radioélément présent dans l'échantillon est exprimée en becquerel par kilogramme sec (Bq / kg sec) ou becquerel par litre (Bq/l), suivi de son incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95%. Toute activité exprimée, y compris la limite de détection, est rapportée à la date de référence indiquée dans les tableaux de résultats. La siccité des échantillons solides est également indiquée (Psec/Pfrais) ; la valeur donnée est à considérer avec prudence car elle dépend des méthodes employées pour le traitement et la conservation de l'échantillon.

Radionucléide	Energie (keV) pour le calcul de la Ld	Energie(s) (keV) pour le calcul de l'activité	Observation(s)
Radionucléides artificiels			
²⁴ Na	1368,6	1368,6	Produit d'activation
⁴⁶ Sc	889,2	889,2 – 1120,5	Produit d'activation
⁵² Mn	935,52	744,2- 935,5	Produit d'activation
⁵⁴ Mn	834,8	834,8	Produit d'activation
⁵⁵ Co	931,5	931,5	Produit d'activation
⁵⁶ Co	846,76	846,8-1238,3	Produit d'activation
⁵⁷ Co	122,06	122,06	Produit d'activation
⁵⁷ Ni	1377,6	127,3-1377,6	Produit d'activation
⁵⁸ Co	810,8	810,8	Produit d'activation
⁶⁰ Co	1332,5	1173,2 – 1332,5	Produit d'activation
⁶⁵ Zn	1115,5	1115,5	Produit d'activation
⁸² Br	776,5	776,5 – 554,3	Produit d'activation
¹²² Sb	564,1	564,1 – 692,8	Produit d'activation
¹²⁴ Sb	602,7	602,7 – 1690,9	Produit d'activation
¹²³ I	158,9	158,9	Produit d'activation
¹³⁷ Cs	661,7	661,7	Produit de fission
¹³¹ Ba	496,3	496,3 – 123,8	Produit d'activation
¹³³ Ba	356	356 – 81,0	Produit d'activation
¹⁵³ Sm	103,1	103,1	Produit d'activation
¹⁵² Eu	121,8	344,3 – 778,9 – 1408	Produit d'activation
⁴⁰ K	-	1460,8	
⁷ Be	477,6	477,6	

Tableau A : radionucléides émetteurs gamma caractéristiques rapportés dans les tableaux de résultats et leur(s) énergie(s) utilisée(s) pour les calculs de la limite de détection et de l'activité massique ou volumique

8. Analyse par scintillation liquide

Le dosage du tritium s'effectue avec une chaîne de spectrométrie bêta à scintillation liquide, modèle TRI-CARB 2250CA de Packard. Le dispositif est réfrigéré en permanence à l'aide d'un groupe froid. La salle des analyses est climatisée.

Les géométries de comptage employées sont des fioles en polyéthylène bas bruit de fond anti-statique (référence 6000477) distribuées par la société Perkin Elmer.

L'étalonnage est effectué à l'aide d'une solution HTO certifiée et tient compte de l'affaiblissement lumineux (Quenching). Dans tous les cas, cet ensemble est déterminé pour une matrice analogue à celle des échantillons à mesurer. La fenêtre de comptage utilisée pour le mesurage de l'activité volumique du tritium s'étend de 0 à 6,5 keV. Le mouvement propre (ou bruit de fond) est déterminé à l'aide de l'eau de source minérale naturelle « des Abatilles ».

La grandeur déterminée est l'activité en becquerel (Bq) par litre (L) ou activité volumique. Elle est suivie de son incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95%. Seules les activités volumiques supérieures à la limite de détection de la chaîne d'analyse sont exprimées.

Toute activité exprimée, y compris la limite de détection, est rapportée à la date de fin de prélèvement.

ANNEXE 2 : Intercomparaisons et qualifications techniques

1. Références normatives

NF M60 série 780 Énergie nucléaire – Mesure de la radioactivité dans l'environnement – Bioindicateurs ; Parties 0 à 5 ; mars 2001.

Bibliographie :

Spectrométrie gamma appliquée aux échantillons de l'environnement. Editions TEC&DOC. 238 pages. Octobre 2002.

Les radioisotopes en recherche biologique - Détection et radioprotection. G. SIMONNET. Editions Masson, 1994.

NUCLEIDE-LARA (version de juillet 2000) : bibliothèque de données nucléaires utilisée pour la spectrométrie gamma communiquée par le Bureau National de Métrologie.

2. Agréments / Intercomparaisons

Le laboratoire de l'ACRO participe depuis 1997 à des intercomparaisons d'envergure nationale, organisées par l'Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (IRSN). Avec la mise en place du réseau national de mesure, la durée d'un cycle d'exercice inter laboratoires pour un couple [Matrice-Radionucléide] est de quatre ans. Actuellement, le laboratoire de l'ACRO offre la possibilité de mesurer le radon dans l'air, le tritium (HTO) dans les eaux et les radionucléides émetteurs gamma, quelque soit la matrice. D'autres mesures sont en cours de développement.

Les méthodes d'analyses sont conformes aux normes existantes ainsi qu'aux exigences organisationnelles et techniques fixées par la norme ISO/CEI 17025.

A ce jour, le laboratoire dispose d'**agréments** pour la mesure de la radioactivité dans l'environnement et la mesure du radon

Agréments du laboratoire de l'ACRO	Attribués par :	Références	Validité	Nb
Habilitation à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public.	Autorité de Sécurité Nucléaire	CODEP-DIS-2011-038822 du 11/7/11	15/09/16	1
Mesures dans l'environnement				
Agrément pour la mesure du tritium dans l'eau	Autorité de Sécurité Nucléaire	CODEP-DEU-2014-02044	30/06/15	1
Agrément pour la mesure des radionucléides émetteurs gamma dans des matrices biologiques . $\gamma < 100 \text{ keV}$ et $\gamma > 100 \text{ keV}$	Autorité de Sécurité Nucléaire	CDEP-DEU-2014-028255	31/12/18	2
Agrément pour la mesure des radionucléides émetteurs gamma dans les eaux $\gamma < 100 \text{ keV}$ et $\gamma > 100 \text{ keV}$	Autorité de Sécurité Nucléaire	CODEP-DEU-2010-031543 du 15/6/10	30/06/15	2
Agréments pour la mesure dans les matrices sols : Isotopes de l'uranium ; Isotopes du Thorium ; radium-226 et descendants ; radium-228 et descendants et Uranium pondéral.	Autorité de Sécurité Nucléaire	CODEP-DEU-2010-031543 du 15/06/10.	30/06/15	5
Agrément pour la mesure des radionucléides émetteurs gamma dans les sols $\gamma < 100 \text{ keV}$ et $\gamma > 100 \text{ keV}$	Autorité de Sécurité Nucléaire	CODEP-DEU-2011-031763 du 15/6/11	30/06/16	2